

The screenshot shows a software configuration window titled "Drägerware.Server Konfiguration - Musterstadt - 2025.2.149.4". On the left is a sidebar menu under "Einstellungen" (Settings) containing items like Allgemein, Workplace, Benachrichtigungen, X-Dock Verbindung, Air Guard Verbindung, Webservices, ZMS-Kopplung, Android App, and Webservice API. The main area has a "Speichern" (Save) button at the top. Below it is a section "Verbindungsparameter GDC" with two fields: "API URL*" containing "https://api.draeger.net/gasdetectionconnect-public" and "API Key*" which is masked with "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX". A "Verbindung testen" (Test connection) button is to the right. At the bottom is a section "Importeinstellungen" with a message: "Die Konfiguration befindet sich jetzt in den systemweiten Einstellungen der Werkstatt Software".

Über diese Schaltfläche kann die Verbindung zur Datenbank überprüft werden.


Jetzt synchronisieren

Durch Klick auf diese Schaltfläche werden die Daten unabhängig von den Zeiteinstellungen synchronisiert.

Importeinstellungen

Diese Einstellungen wurden in die **Systemweiten Einstellungen** der Drägerware verschoben.

Bei Änderungen an diesen Einstellungen ist es jetzt nicht mehr erforderlich die Systemdienste neu zu starten.

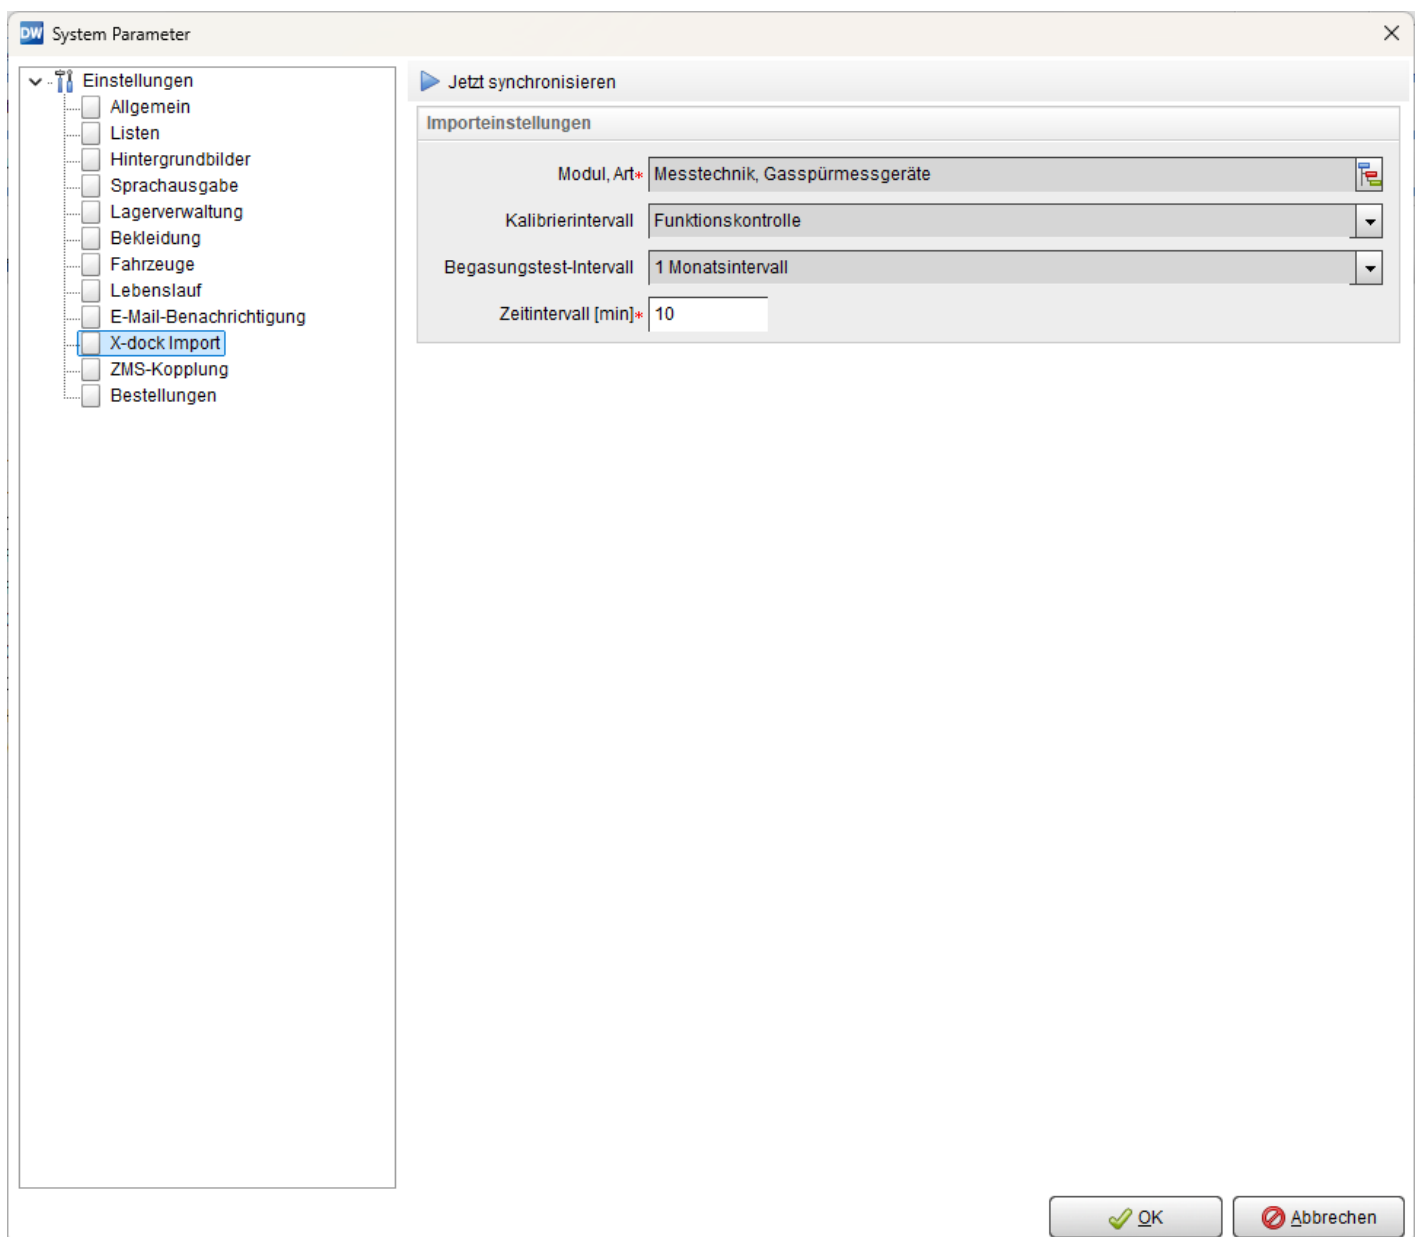

Modul, Art

Hier sind das Modul und die Art auszuwählen, in dem die Gasspürmessgeräte in der Drägerware.Werkstatt verwaltet werden sollen.

Kalibrierintervall

Um das Datum der nächsten Kalibrierung aus X-Dock zu übernehmen, muss hier ein Intervall aus der Drägerware.Werkstatt ausgewählt werden. Hierbei wird der Zeitraum des Werkstatt-Intervalls ignoriert und immer das nächste Datum aus X-Dock verwendet.

Begasungstest-Intervall

Um das Datum der nächsten Begasung (Bumptest) aus X-Dock zu übernehmen, muss hier ein Intervall aus der Drägerware.Werkstatt ausgewählt werden. Hierbei wird der Zeitraum des Werkstatt-Intervalls ignoriert und immer das nächste Datum aus X-Dock verwendet.

Zeitintervall [min]

Dieses Intervall bestimmt den Zeitabstand, in dem ein Datenabgleich zwischen Gas Detection Connect und der Drägerware.Werkstatt durchgeführt wird. Ein Wert kleiner 10 Minuten ist **nicht** möglich.

Jetzt synchronisieren

Diese Schaltfläche startet die Synchronisation manuell, unabhängig von der eingestellten Zeitdauer.